


Installatiehulp

Voor gebruik met de modellen
222, 223, 622, 623 en 625




Apparatuurwaarschuwing

Bevestig de installatiehulp alleen op een voor deze modellen ontworpen dwarsstang. Bevestig deze **NIET** direct op de aansluitstukken van de stoel om schade te voorkomen.




Stap 1:

- A) Til stoelgedeelte op.
- B) Haak de dwarsstang van de onderzoeksstoel in de grendellip.

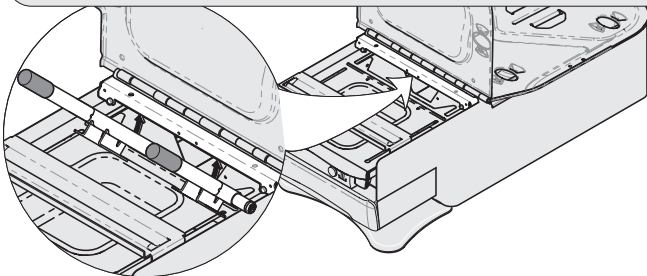

Stap 2:

Leg de dwarsstang van de onderzoeksstoel plat op de metalen crossbar.

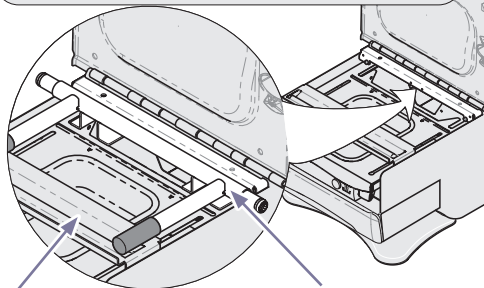


Metalen crossbar

Dwarsstang onderzoeksstoel


Stap 3:

- A) Druk op Base Up (basis omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.

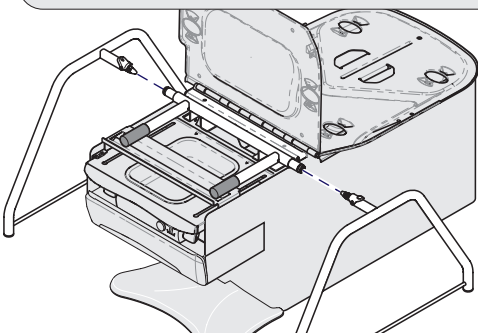

Stap 4:

Druk op Base Down (basis omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

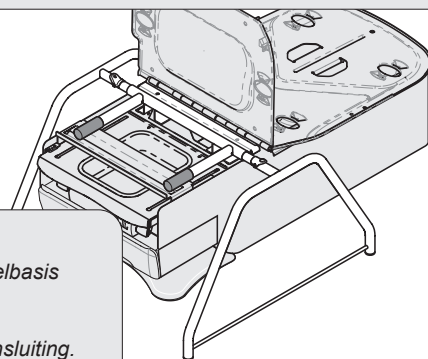

Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.

* Ga voor andere talen naar <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.

** Zie gebruikershandleiding voor aanwijzingen en waarschuwingen.

003-2557-10 Rev. AA4 (28/04/2022)

Ned. - 1


midmark®


Installatiehulp

Voor gebruik met de modellen
222, 223, 622, 623 en 625




Apparatuurwaarschuwing

Bevestig de installatiehulp alleen op een voor deze modellen ontworpen dwarsstang. Bevestig deze **NIET** direct op de aansluitstukken van de stoel om schade te voorkomen.




Stap 1:

- A) Til stoelgedeelte op.
- B) Haak de dwarsstang van de onderzoeksstoel in de grendellip.

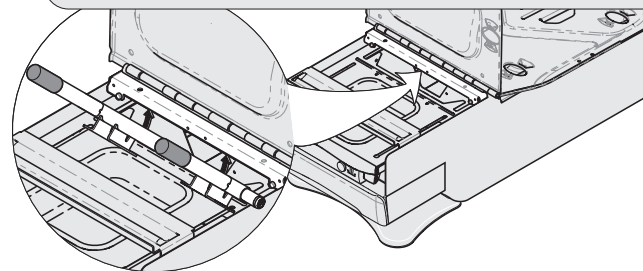

Stap 2:

Leg de dwarsstang van de onderzoeksstoel plat op de metalen crossbar.

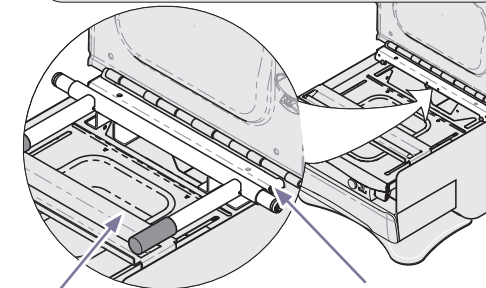


Metalen crossbar

Dwarsstang onderzoeksstoel


Stap 3:

- A) Druk op Base Up (basis omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.

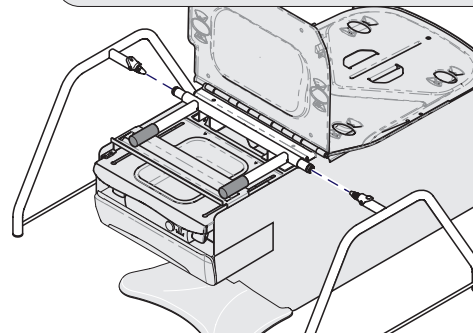

Stap 4:

Druk op Base Down (basis omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

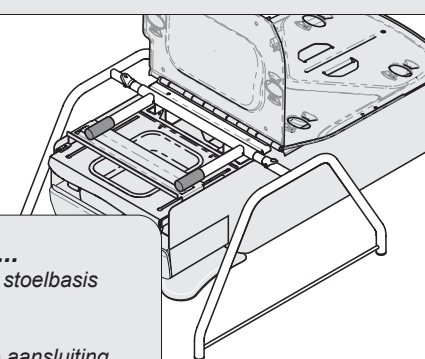

Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.

* Ga voor andere talen naar <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.

** Zie gebruikershandleiding voor aanwijzingen en waarschuwingen.

003-2557-10 Rev. AA4 (28/04/2022)

Ned. - 1


midmark®



Installatiehulp

Voor gebruik met de modellen
230, 630 (-001 tot -009),
641 en 647



Apparatuurwaarschuwing

Bevestig de installatiehulp alleen op een voor deze modellen ontworpen dwarsstang. Bevestig deze **NIET** direct op de aansluitstukken van de stoel om schade te voorkomen.



Stap 1:

- A) Druk op Tilt Up (naar voren hellen) op de handbediening.
- B) Plaats de installatiehulp voor de behandelingsstoel achter de aandrijfas voor het hellen.
- C) Druk op Tilt Down (naar achteren hellen) op de handbediening.

Dwarsstang
behandelingsstoel

Stap 2:

- A) Druk op Base Up (basis omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de poten van de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.

Stap 3: Druk op Base Down (basis omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.

MA8602-1i


Installatiehulp

Voor gebruik met de modellen
230, 630 (-001 tot -009),
641 en 647



Apparatuurwaarschuwing

Bevestig de installatiehulp alleen op een voor deze modellen ontworpen dwarsstang. Bevestig deze **NIET** direct op de aansluitstukken van de stoel om schade te voorkomen.

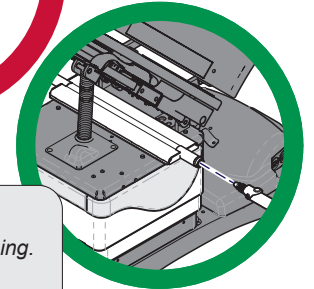

Stap 1:

- A) Druk op Tilt Up (naar voren hellen) op de handbediening.
- B) Plaats de installatiehulp voor de behandelingsstoel achter de aandrijfas voor het hellen.
- C) Druk op Tilt Down (naar achteren hellen) op de handbediening.

Dwarsstang
behandelingsstoel

Stap 2:

- A) Druk op Base Up (basis omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de poten van de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.

Stap 3: Druk op Base Down (basis omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.

MA8602-1i