Montagehandbuch
Laufrollen *[9A554]*

Für die Modelle:
630 (-010 /-011 /-020 /-021)

Ausgangssprache: Englisch

Einschränkungen:
Montieren Sie keine Laufrollen an den Drehsockel.

Schritt 1: Ziehen Sie das Netzkabel des Tisches ab.

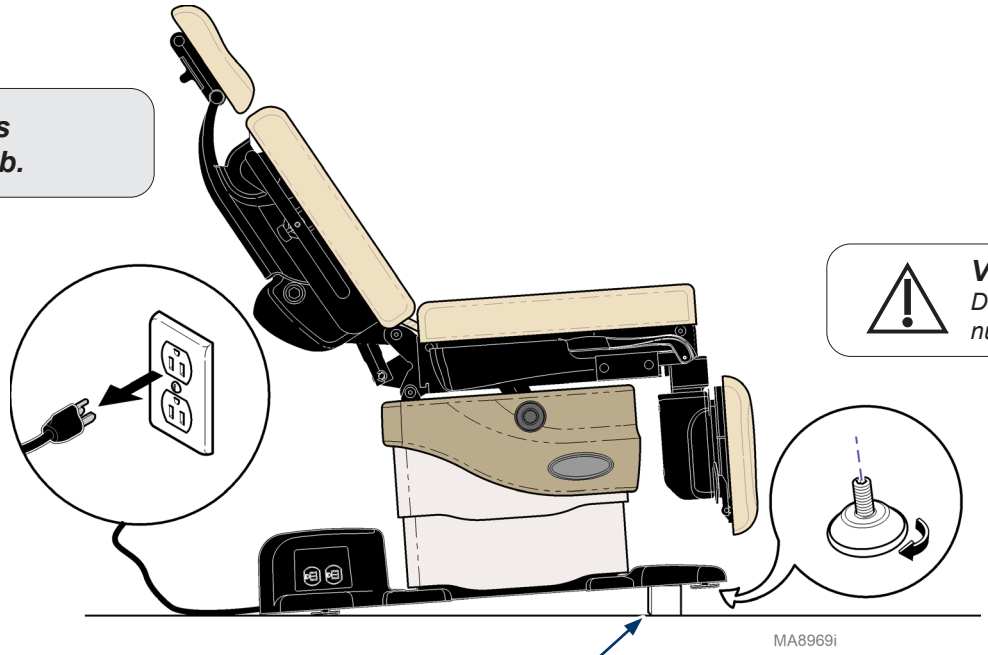

Vorsicht!
Dieser Tisch wiegt ca. 215 kg (475 lb.) und sollte nur mit Unterstützung angehoben werden.

Schritt 2: Entfernen Sie die Nivellierschrauben.

A) Heben Sie das Fußende des Tisches an.
B) Positionieren Sie eine 10 x 10 cm (4x4 in.)-Stütze unter dem Sockel.
C) Entfernen Sie zwei Nivellierschrauben.

TP200 Rev. A

© 2013 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1.800.643.6275 | 1.937.526.3662 | midmark.com

Style A 003-2659-01 Rev. AA2 (16/8/22)

Schritt 3: Montieren Sie die Laufrollen am Fußende.

A) Drücken Sie den Bremshebel herunter, um die Laufrolle zu sperren.
B) Winden Sie die Laufrolle in den Sockel.
C) Zur Sicherung stellen Sie die Laufrolle fest.

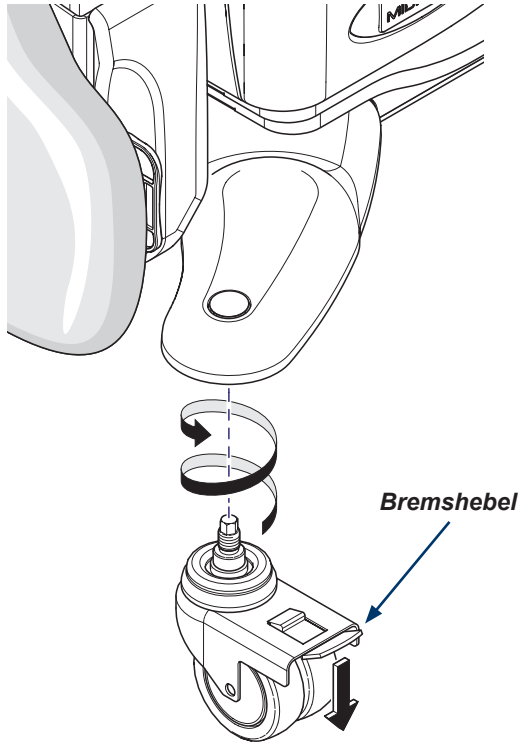

MA8970i

Vorsicht!
Um Verletzungen zu vermeiden, sperren Sie die Laufrollen des Fußendes, bevor Sie Schritt 4 ausführen.

Schritt 4: Montieren Sie die Laufrollen am Kopfende.

A) Heben Sie das Kopfende des Tisches an.
B) Positionieren Sie eine 10 x 10 cm (4x4 in.) -Stütze unter dem Sockel.
C) Entfernen Sie die zwei Nivellierschrauben.
D) Drücken Sie den Bremshebel herunter, um die Laufrolle zu sperren.
E) Winden Sie die Laufrolle in den Sockel.
F) Zur Sicherung stellen Sie die Laufrolle fest.

Hinweis: Eine Abbildung finden Sie auf Seite 1.

Vorsicht!
Um Verletzungen zu vermeiden, sperren Sie vor der Durchführung von Behandlungen immer die Laufrollen.

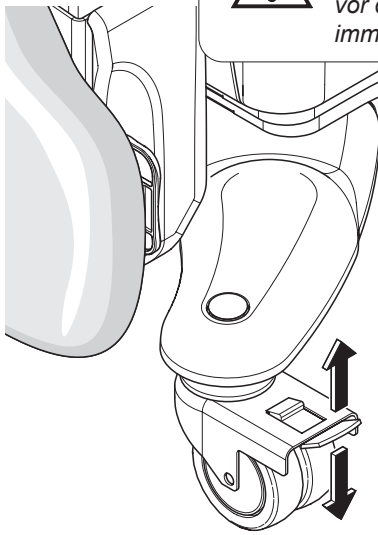

MA8972i

Zum ENTSPERREN der Laufrolle(n)...
Heben Sie den Bremshebel an.

Zum SPERREN der Laufrolle(n)...
Drücken Sie den Bremshebel herunter.

Vorsicht!
Um Verletzungen zu vermeiden, bewegen oder positionieren Sie den Tisch niemals neu, wenn ein Patient darauf liegt.

TP200 Rev. A

midmark®

© 2013 Midmark Corp. | 60 Vista Drive Versailles, OH 45380 USA | 1.800.643.6275 | 1.937.526.3662 | midmark.com